




## RIEPILOGO QUESTIONARIO DPI ANTEV


Al 14 marzo 2020 ore 18,30 – Campione di 50 tecnici

### AMBITO SPECIFICO DELL'ATTIVITA' INDICATA

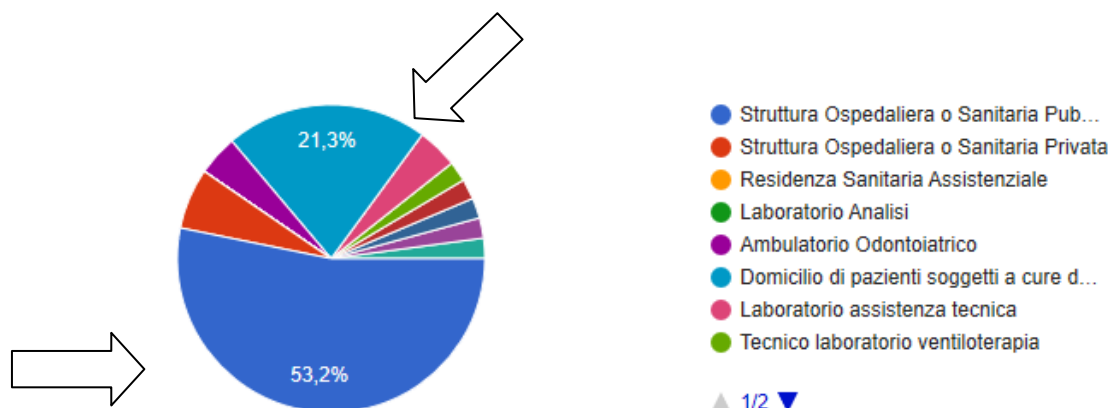

Note: la maggior parte degli intervistati svolge la propria attività in ambito Ospedaliero o Sanitario Pubblico (a contatto con pazienti ospedalizzati) e in ambito domiciliare (a contatto con pazienti domiciliati).


### REGIONE



Note: la maggior parte degli intervistati svolge la propria attività nelle regioni italiane attualmente tra i primi posti nel numero di infezioni (Lombardia, Veneto, Friuli V.G.)




## DPI A DISPOSIZIONE




Note: molti operatori hanno a disposizione DPI inadeguati e/o in numero insufficiente in relazione all'attività che svolgono (manutenzione e verifica di apparecchi elettromedicali).

## MARCATURA CE DEI DPI




Note: vengono segnalati DPI ove la marcatura CE è assente, non pertinente o, probabilmente, mendace (simbologia non corretta, provenienza non UE)

### SMALTIMENTO DEI DPI

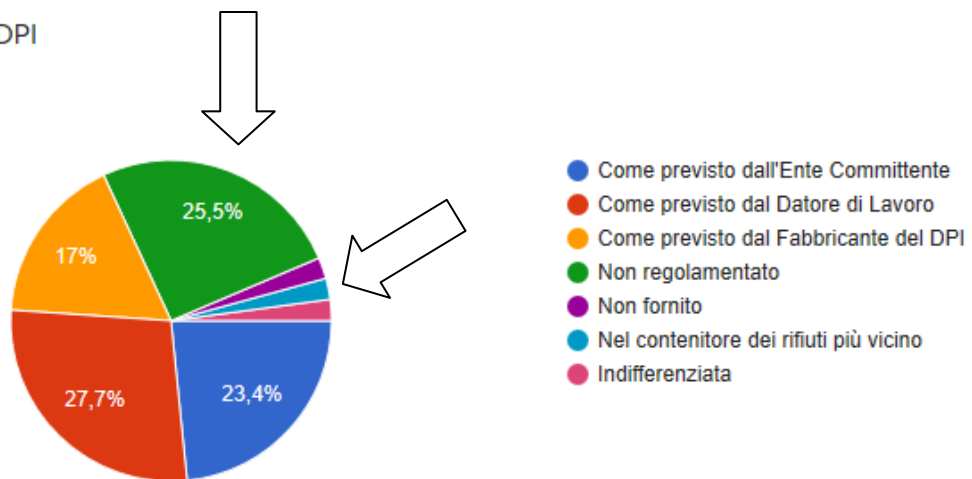

Note: un terzo dei DPI viene potenzialmente smaltito non correttamente


### FORMAZIONE SUL RISCHIO CORONAVIRUS COVID-19



Note: la maggior parte degli intervistati dichiara di essersi formato sul rischio autonomamente, solo circa il 60% dichiara di essere stato formato dal DL e/o una percentuale inferiore al 30% dall'Ente Committente (vi sono sovrapposizioni).




## ATTESTAZIONE DELLA FORMAZIONE



Note: la maggior parte degli intervistati non ha ricevuto alcuna attestazione circa l'eventuale formazione surrogata, oltre la metà degli intervistati dichiara di essere stato formato nei vari ambiti ma di non aver ricevuto alcun attestato (molti riferiscono formazione di tipo "informale", non d'aula o standardizzata)


## PROCEDURE SPECIFICHE COVID-19



Note: oltre un quarto degli intervistati non ha procedure specifiche per lo svolgimento dell'attività lavorativa in considerazione dei rischi legati al COVID-19.




### APPARECCHI SOTTOPOSTI A SOLA VERIFICA




Note: quasi il 60% degli intervistati verifica apparecchi che hanno avuto contatto con pazienti certamente o potenzialmente infetti. Quasi il 60% segnala che non ha evidenza o certezza dello stato di disinfezione o sanificazione degli apparecchi sui quali esegue le verifiche di sicurezza o prestazionali.

### APPARECCHI SOTTOPOSTI A MANUTENZIONE




Note: quasi il 70% degli intervistati effettua manutenzione su apparecchi che hanno avuto contatto con pazienti certamente o potenzialmente infetti. Quasi il 60% segnala che non ha evidenza o certezza dello stato di disinfezione o sanificazione degli apparecchi sui quali esegue la suddetta manutenzione.

### LOCALI IN CUI SI ESERCITA LA PROPRIA ATTIVITA'



Note: oltre il 50% degli intervistati lavora in locali in presenza di apparecchi o pazienti certamente o potenzialmente infetti.


### QUALE SENSAZIONE RELATIVA ALLA SICUREZZA DA COVID-19 PROVA NELL'ESERCIZIO DELLA SUA ATTIVITA'?



Note: solo il 6% degli intervistati non segnala preoccupazioni relative all'emergenza sanitaria in atto.



QUALE LIVELLO DI STRESS CORRELATO ALLA SUA ATTIVITA' PROVA NELL'ESERCIZIO DELLA STESSA IN CONSIDERAZIONE DEL RISCHIO DA COVID-19?

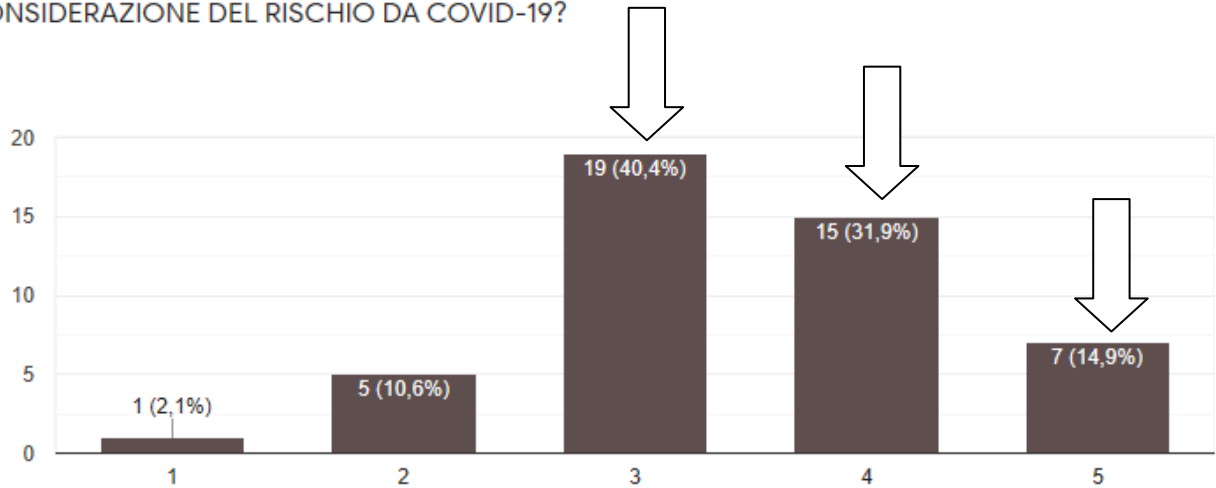

Note: solo il 2% degli intervistati non segnala livelli di stress correlati al rischio COVID-19.